


VERIFICATION DU RECAL ANABOLISANT

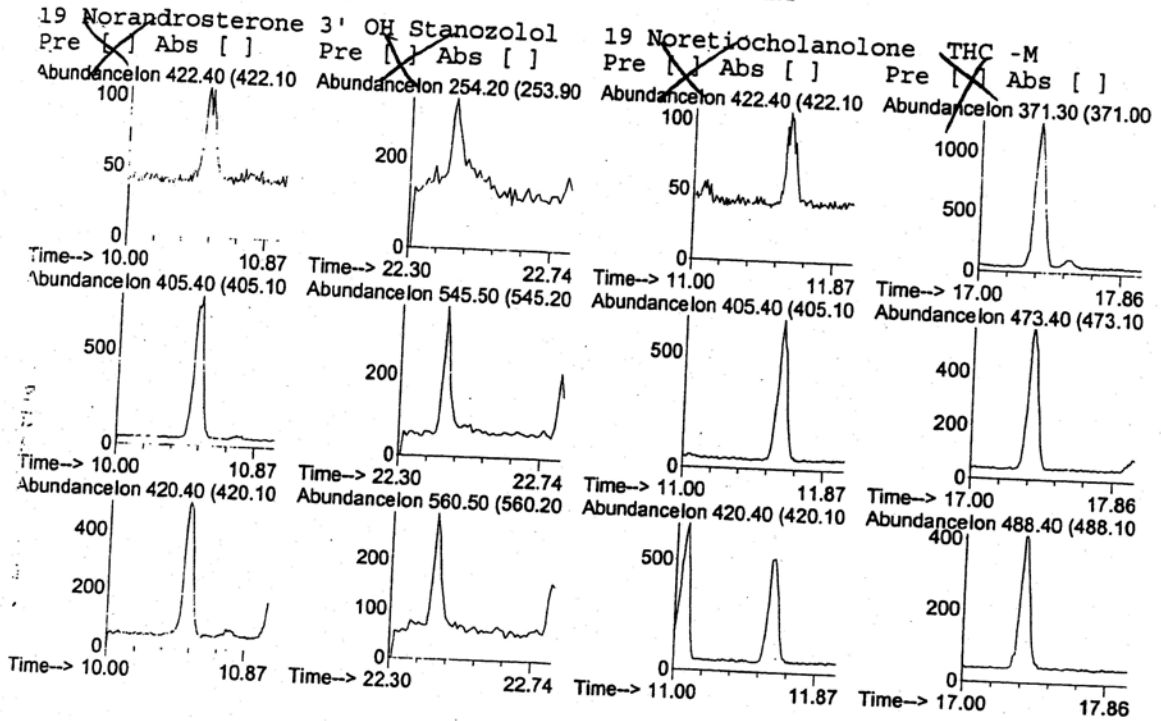

!Date : 21/07/06
 !Opérateur : 31
 !Résultats :
 Conforme
 Non conforme
 !Remarques : Avec EA 96